

処方箋医薬品<sup>注)</sup>  
経皮吸収型・気管支拡張剤

# ツロブテロールテープ0.5/1/2「EMEC」

注) 注意 - 医師等の処方箋により使用すること

## 包装変更のご案内

エルメッド エーザイ株式会社

謹啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記製品の内袋フィルムデザイン等を変更いたします。

今後もより一層のご愛顧を頂きますようお願い申し上げます。

謹白

### ■変更開始ロット等一覧[メーカーコード：623]

包種、統一商品コード等に変更はございません。

製品名	包装	変更開始ロット	変更開始品の使用期限	代理店様への出荷時期	個装箱へのお知らせ表示
ツロブテロールテープ0.5「EMEC」	70枚入	BN01A	2017年1月	2015年4～5月	<b>包装変更品 新コード表示</b>
	350枚入	BN01A	2017年1月	2015年6月	
ツロブテロールテープ1「EMEC」	70枚入	CN03B	2017年2月	2015年8月	
	350枚入	EN05B	2017年4月	2015年11月	
ツロブテロールテープ2「EMEC」	70枚入	CN06C	2017年2月	2015年6月	
	350枚入	CN09C	2017年2月	2015年7月	

・出荷時期につきましては在庫状況により若干前後することがあります。



・今回の変更開始ロットより、個装箱のJANコードを削除しました。

### ■変更内容①：内袋フィルムデザイン

内袋フィルムに調剤包装単位の新バーコードを表示しました。

内袋フィルムを切る目安となる点線を入れ、フィルムを切ってテープを取り出しやすくいたしました。

なお、内袋フィルムの大きさの変更はございません。

ツロブテロールテープ「EMEC」 内袋フィルムデザイン (例：0.5mg)	
変更前	変更後
	

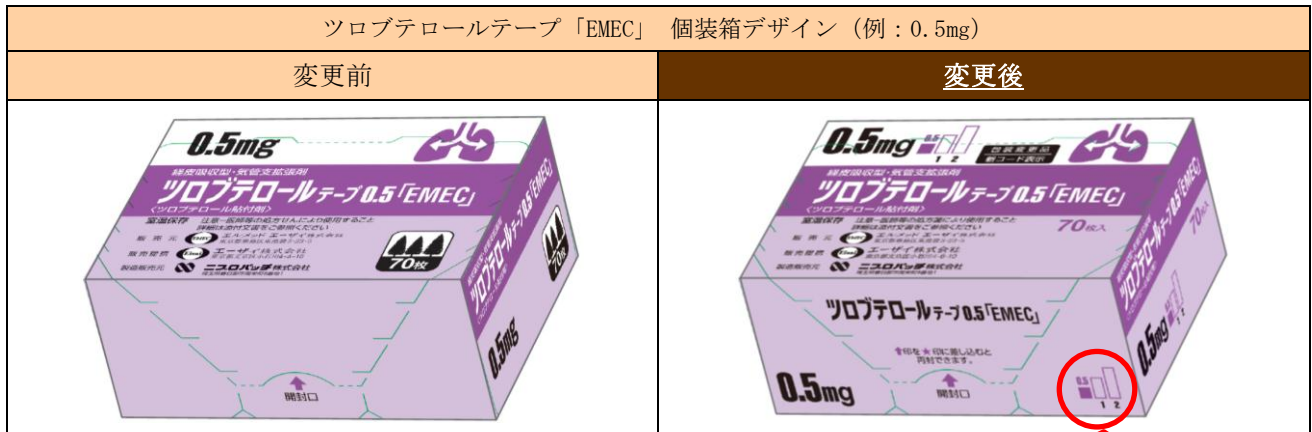
\*ツロブテロールテープ1/2「EMEC」も、ツロブテロールテープ0.5「EMEC」に準じたデザインに変更いたします。

## ■変更内容②:個装箱デザイン

内袋フィルムデザイン変更に伴い、箱デザインを変更し、併せて JANコードも削除いたしました。

箱デザインについては、開封口の面からも製品名や規格が分かるようにいたしました。

なお、箱の大きさに変更はございません。




他に何規格があるか分かり、規格の取り違えを防ぐよう、  
他含量表示マークを追加いたしました

\*ツロブテロールテープ 1/2「EMEC」も、ツロブテロールテープ 0.5「EMEC」に準じたデザインに変更いたします。


## 患者様向けお知らせカード

今回の包装変更品については、個装箱へお知らせカードを同梱しておりますのでご使用下さい。

なお、追加でお知らせカードをご要望の際は、お手数ですが、弊社MRまたは下記のエーザイ hhc ホットラインまでお問い合わせください。

 **患者さまへのお知らせ**

- 今まで服用されていたお薬のフィルムデザインを変更いたしました。
- お薬の成分・効果に変わりはありません。先生のご指示どおり正しくお使い下さい。

 ツロブテロールテープ「EMEC」 TTUL(1)007  
2014年12月作成

 エルメッド エーザイ株式会社  
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-5  
URL <http://www.emec.co.jp>

エーザイ hhcホットライン  
EEダイヤル  **0120-223-698**  
(受付時間 平日9:00~18:00/土日・祝日9:00~17:00)

TTU(H)003C  
2015年7月改訂